
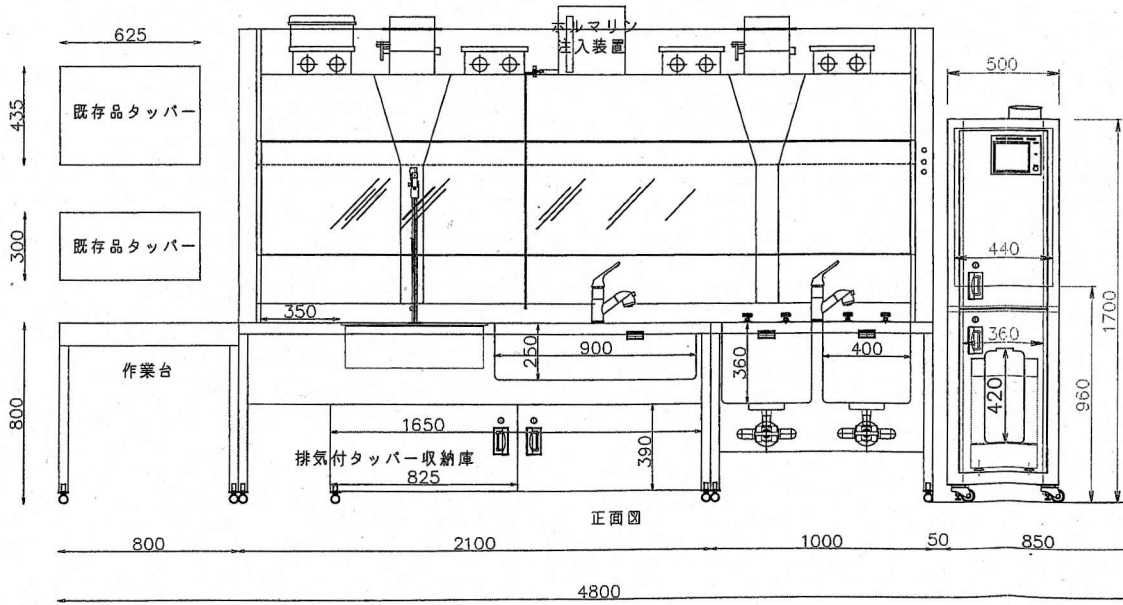


建築設備図

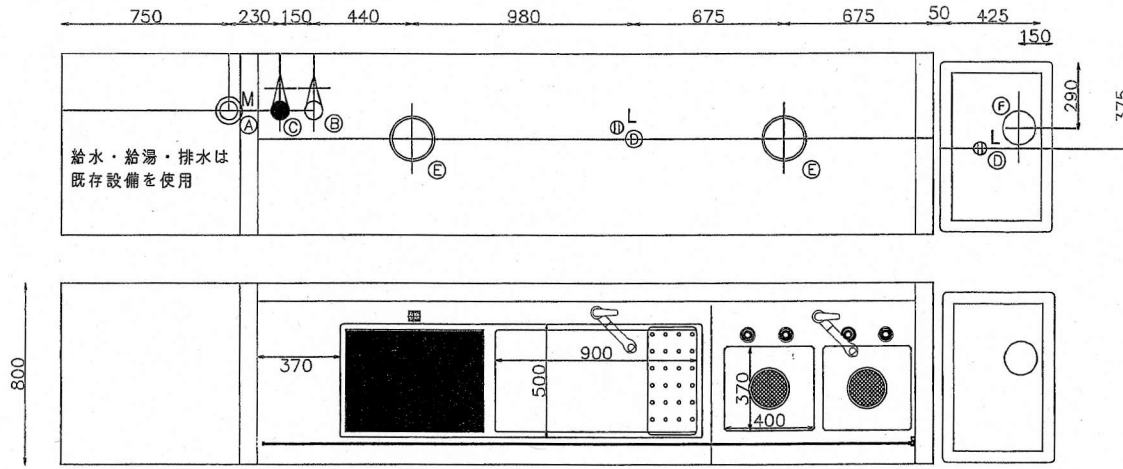

- A) 排水 : 40A / FL+100 (PVC)
- B) 給水 : 20A / FL+100 (バルブ止め)
- C) 給湯 : 20A / FL+100 (バルブ止め)
- D) 電源 : AC100V 15A
(天井壁コンセントロック付)
- E) 排気口 : CH-100
必要排気風量 : 785CMH×2
機内圧損 : 80Pa
- F) 排気口 : CH-100
必要排気風量 : 600CMH
機内圧損 : 50Pa
- G) 扉全開時の水平層流排気フード
撮影固定作業流し台の高さは、
2850mmになります。

25		
24		
23		
22		
21		
20		
19		
18		
17		
16		
15		
14		
13		
12		
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
品番	名称	仕様
記	水平層流排気フード	必要排気風量 : 1570CMH
		機内制圧 : 80Pa
事	ホルマリン送液回収装置	必要排気風量 : 600CMH
		機内制圧 : 50Pa